schuchmann

BOB

système hygiénique universel de Rifton

Mode d'emploi

CE

Chère cliente, cher client,

Nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir choisi notre produit et, ce faisant, de la confiance que vous nous accordez.

Avant la première mise en service de votre produit, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir compte. Veuillez noter que les remarques et les figures de ce mode d'emploi peuvent différer de votre produit en raison des accessoires utilisés.

Sous réserve de modifications techniques.

Information importante !
Veillez à ce que le présent mode d'emploi se trouve toujours à proximité du produit.

L'équipe Schuchmann

schuchmann

Contenu **Page**

1. Préparation à l'utilisation du système hygiénique
1.1 Transport....3
1.2 Mesures de sécurité avant l'utilisation....3
1.3 Élimination correcte du matériau d'emballage....3
1.4 Conservation du mode d'emploi....3

2. Description du produit
2.1 Informations générales....3
2.2 Domaines d'application, utilisation conforme....4
2.3 Utilisation non conforme/avertissements....4
2.4 Équipement du modèle de base....5
2.5 Liste des accessoires....5
2.6 Vue d'ensemble du produit....5

3. Réglages
3.1 Réglage de l'angle du dossier....6
3.2 Réglage des accoudoirs....6
3.3 Réglage de la profondeur du siège....7

4. Accessoires
4.1 Bâtis....7
4.1.1 Bâti mobile & fixe....8
4.1.2 Bâti pour baignoire....8
4.1.3 Bâti de voyage....9
4.2 Rembourrage....9
4.3 Appuie-tête....10
4.4 Pelotes thoraciques....10
4.5 Sangle pelvienne....11
4.6 Sangle thoracique....11
4.7 Sangle thorax-épaules....12
4.8 Cales pour cuisses....12
4.9 Repose-pieds....13
4.9.1 Montage sur le siège de toilette....13
4.9.2 Réglage de la hauteur du repose-pieds....14
4.9.3 Réglage de l'angle du repose-pieds....14
4.10 Cale pour mollets....14
4.11 Attaches pour pieds....15
4.12 Table/tablette d'appui....15
4.13 Étriers de montage....16
4.14 Plot d'abduction....16
4.15 Déflecteur....16
4.16 Seau hygiénique....16

Contenu **Page**

5. Maintenance et nettoyage
5.1 Entretien....18
5.2 Maintenance.... 18
5.3 Pièces détachées....18
5.4 Durée d'utilisation et réutilisation.... 18

6. Caractéristiques techniques....19

7. Garantie.... 20

8. Identification
8.1 Déclaration de conformité CE....21
8.2 Numéro de série/Date de fabrication....22
8.3 Version du produit....22
8.4 Version du document....22
8.5 Nom et adresse du fabricant, revendeur....22

1. Préparation à l'utilisation du système hygiénique

1.1 Transport

Dès la réception de votre produit, veuillez vérifier qu'il est complet, ne comporte aucun vice et n'a subi aucun dommage pendant le transport.
Vérifiez la marchandise en présence de la personne qui vous la remet.
En cas de dommage dû au transport, veuillez établir une liste exacte (constatation des dommages) en présence de la personne qui a vous remis le produit. Envoyez, ensuite, une réclamation écrite au revendeur correspondant.

1.2 Mesures de sécurité avant l'utilisation

Pour une utilisation correcte du système hygiénique, l'accompagnateur doit avoir suivi une initiation précise et détaillée. Avant la première mise en service de votre siège de douche et de toilette, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement et respecter le présent mode d'emploi.

1.3 Élimination correcte du matériau d'emballage

Il est conseillé de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur éventuellement requis. Si vous devez nous renvoyer votre produit pour sa réparation ou dans le cadre de la garantie, veuillez utiliser si possible le carton d'origine afin d'emballer parfaitement le produit.
Si vous souhaitez jeter le carton d'origine, éliminez-le dans le respect de la réglementation, en contribuant au recyclage durable des ressources. Veuillez recycler les matériaux d'emballage en fonction de leur type.
Ne laissez jamais les matériaux d'emballage sans surveillance, ils présentent une source possible de danger.

1.4 Conservation du mode d'emploi

Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le avec le produit lors d'une éventuelle réutilisation.

2. Description du produit

2.1 Informations générales

Toutes les pièces en acier (écrous, boulons, vis etc.) sont en acier inoxydable. Les parties rembourrées sont en mousse intégrale de polyuréthane imperméable. Le cadre en aluminium et acier est thermolaqué.
Les sangles sont en fibre de polypropylène et en fibres mélangées à séchage rapide pour le rembourrage. Les pièces en plastique sont en diverses résines synthétiques moulées par injection. Tous les matériaux sont exempts de latex, plomb et phthalates.

BOB est un système hygiénique universel à usage domestique et institutionnel. Sa coque d'assise de forme anatomique maintient parfaitement les enfants et adolescents. Disponible en 3 tailles, il est utilisable comme siège de toilette et de douche. Comme siège de toilette il s'utilise au-dessus des toilettes, directement sur les toilettes ou en autonomie avec un seau hygiénique.

2.2 Domaines d'application, utilisation conforme

BOB est utilisable comme siège de toilette au-dessus des toilettes ou en autonomie avec le seau hygiénique. Par ailleurs, il peut être utilisé comme siège de toilette directement sur les toilettes et comme siège de douche. Veuillez tenir compte des remarques suivantes :

Au-dessus des toilettes
Le bâti mobile permet de pousser BOB sans problème au-dessus des toilettes. Le réglage en hauteur permet de l'adapter aux toilettes respectives.

Directement sur les toilettes
Un étrier de montage permet de monter BOB comme siège de toilette fixe sur les toilettes.

Siège de toilette/douche autonome
Combiné avec un bâti (voir 4.1), le siège BOB est utilisable comme siège de toilette/douche autonome.

Siège de douche
Combiné avec le bâti pour baignoire, le siège BOB est utilisable comme siège de douche.

2.3 Utilisation non conforme/avertissements

⚠ ATTENTION !

- Pour une utilisation correcte du produit, l'accompagnateur doit avoir suivi une initiation précise et détaillée.
- Le système hygiénique peut être utilisé uniquement sur un sol plan et stable.
- Pour connaître le poids maximum autorisé du patient, veuillez consulter le point « Caractéristiques techniques » du présent mode d'emploi.
- Toute utilisation du produit sans surveillance est interdite.
- Le système hygiénique n'est pas conçu pour le transport des personnes.
- Pendant les réglages, assurez-vous que l'utilisateur ne puisse pas toucher les pièces mobiles.

2.4 Équipement du modèle de base

- Siège comprenant sangle pelvienne et accoudoirs amovibles
- Profondeur du siège et angle du dossier réglables

2.5 Liste des accessoires

- Bâti mobile
- Bâti fixe
- Bâti pour baignoire
- Rembourrage
- Appuie-tête
- Pelotes thoraciques
- Sangle thorax-épaules
- Cale pour cuisses/mollets
- Table/tablette d'appui
- Déflecteur
- Plot d'abduction
- Seau hygiénique
- Repose-pieds
- Attaches pour pieds
- Étriers de montage
- Cale pour mollets
- Bâti de voyage

2.6 Vue d'ensemble du produit

L'illustration suivante présente les dénominations des pièces essentielles ainsi que les termes que vous pourrez rencontrer lors de la lecture de ce mode d'emploi.

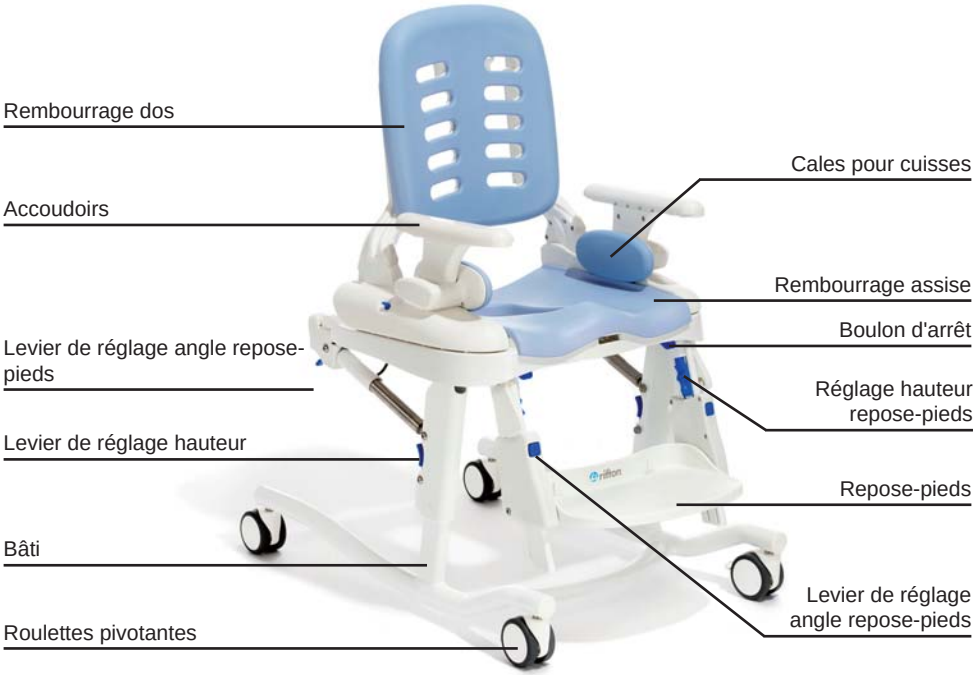

3. Réglages

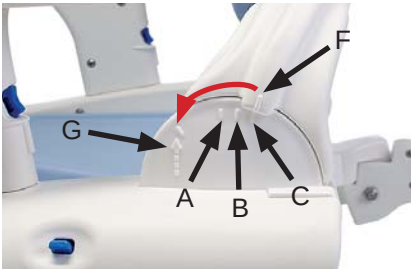

3.1 Réglage de l'angle du dossier

L'angle du dossier peut se régler à 6° vers l'avant (A), 6° vers l'arrière (B), et 18° vers l'arrière (C). Pour régler l'angle du dossier, tirez les deux leviers (D) situés des deux côtés du dossier vers le haut, placez-le dans la position souhaitée, puis relâchez les leviers. Veillez à enclencher le dossier jusqu'au clic sonore.

Montage/démontage du dossier :

Pour démonter le dossier, enlevez d'abord les accoudoirs (E - voir 3.2) et les cales pour cuisses (le cas échéant, voir 4.8). Actionnez les leviers (D) et faites basculer le dossier complètement vers l'avant jusqu'à faire chevaucher les marquages F et G. Vous pouvez maintenant retirer tout le dossier par le haut hors de son logement.

Pour monter le dossier, replacez-le dans son logement en faisant chevaucher les marquages F + G. Tirez ensuite le dossier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa position initiale.

⚠ **N'effectuez le montage/démontage du dossier que si le siège est inoccupé !**

3.2 Réglage des accoudoirs

Pour monter l'accoudoir (E), introduisez la partie inférieure de l'accoudoir dans l'orifice ovale (H) du siège et appuyez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour démonter l'accoudoir, appuyez sur le bouton de déverrouillage (I) et tirez l'accoudoir vers le haut.

3.3 Réglage de la profondeur du siège

La profondeur du siège est réglable sur le siège. Tirez les deux boulons d'arrêt bleus (A) situés sur les côtés vers le haut et veillez à ce que le siège s'enclenche.
De cette manière, les côtés du siège peuvent être complètement retirés vers l'avant permettant de nettoyer la surface située en-dessous.

4. Accessoires

4.1 Bâtis

Un bâti mobile,un bâti fixe, un bâti pour baignoire et un bâti de voyage sont disponibles en option.

Pour placer le siège sur un bâti, placez les deux crochets (B) situés à l'arrière du siège dans les supports (C) du bâti correspondant. Pressez ensuite fermement la partie avant du siège sur le bâti jusqu'à ce que les boulons d'arrêt (D) s'enclenchent avec un clic.

Pour sortir le siège d'un bâti, tirez les deux boulons d'arrêt (D) situés sous les coins avant du siège et soulevez-le hors du bâti en vous penchant en avant par dessus le siège.

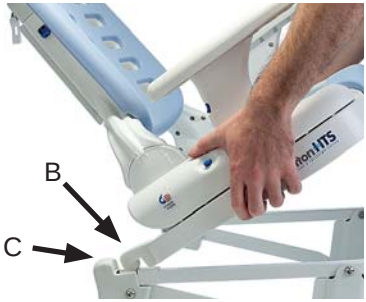

Afin d'éviter les blessures, assurez-vous que les deux crochets du siège sont bien placés dans les supports (C) du bâti et que les deux boulons d'arrêt (D) s'enclenchent avec un clic !

4.1.1 Bâti mobile & fixe

Le bâti mobile et le bâti fixe sont tous deux réglables en hauteur.

Pour abaisser le siège, appuyez sur les deux leviers de réglage en hauteur (A) situés sur les côtés longs du siège, **tout en soutenant le poids du siège**. Abaissez les deux côtés symétriquement pour éviter le blocage du siège. Pour remonter le siège, relevez le repose-pieds (voir 4.9), placez un pied sur le cadre du bâti (B) et soulevez le cadre du siège (nul besoin de desserrer les leviers de réglage en hauteur).

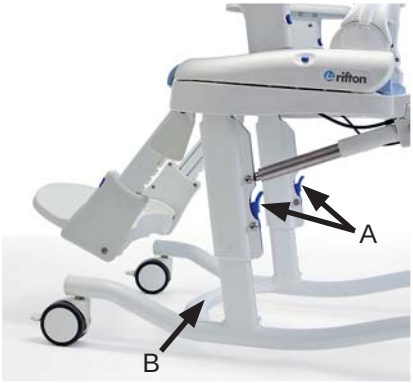

N'effectuer le réglage en hauteur que si le siège est inoccupé !

Le réglage de l'inclinaison du siège est possible sur les bâtis mobiles. Pour ce, actionnez le levier de réglage (C) situés sur le côté arrière droit du siège afin de desserrer les deux ressorts à gaz. Le siège est inclinable à 15° vers l'avant et 15 ° vers l'arrière. BOB est inclinable facilement et sans grand effort même quand l'utilisateur occupe le siège.

Pour serrer le frein, appuyez vers le bas sur le levier de frein (D). Pour desserrer le frein, relevez le levier.

4.1.2Bâti pour baignoire

Le bâti pour baignoire permet de baigner ou de doucher l'utilisateur (montage du siège sur le bâti, voir 4.1).

4.1.3Bâti de voyage

Le bâti de voyage est un bâti léger et pliant avec sac de transport adapté (A). Le bâti tient dans le compartiment arrière du sac (B). Le siège, le dossier, les accoudoirs et autres accessoires tiennent dans le compartiment avant du sac (C).

Pour monter le cadre, dépliez les deux parties du bâti et introduisez l'extrémité carrée d'une des parties dans le tube carré de l'autre partie du bâti (D).

Assurez-vous que les deux parties du cadre sont complètement enclenchées l'une dans l'autre avant de poser le siège. Installez ensuite le siège de toilette sur le bâti (voir 4.1).

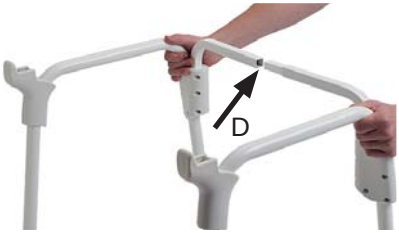

4.2 Rembourrage

Tous les rembourrages sont amovibles pour faciliter le nettoyage. Pour ce, retirez toutes les fermetures-pression (E) de leurs logements (F). Les rembourrages sont en polyuréthane à mousse intégrale résistante. Il existe deux sortes de rembourrages pour sièges. L'un présente une ouverture un peu plus large et est ouvert à l'arrière (G) pour faciliter les soins d'hygiène.

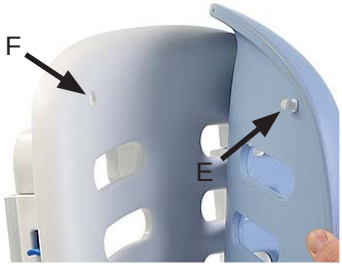

Le deuxième présente une ouverture un peu plus étroite et est fermé à l'arrière (H), de sorte que l'utilisateur est mieux soutenu. Tous les rembourrages sont fixés au moyen de fermetures-pression (E) poussées dans les logements (F) prévus à cet effet.

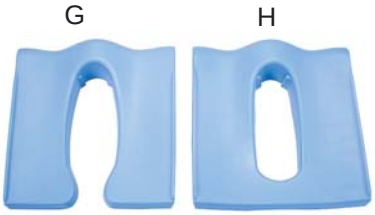

4.3 Appuie-tête

Pour installer et régler l'appuie-tête, appuyez sur le bouton de réglage en hauteur (A). Introduisez l'appuie-tête dans l'orifice prévu à cet effet (B) et réglez la hauteur souhaitée.
Relâchez le bouton (A) et réglez la hauteur souhaitée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic. Pour ajuster la profondeur et l'angle de l'appuie-tête, desserrez le levier tournant ovale (C), mettez l'appuie-tête dans la position souhaitée et resserrez le levier.

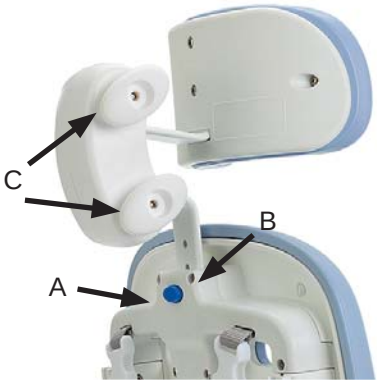

4.4 Pelotes thoraciques

Les pelotes thoraciques sont disponibles avec ou sans sangle thoracique et assurent le positionnement du tronc. Hauteur, angle et écartement peuvent être réglés séparément à l'aide du levier tournant (D) situé derrière le dossier. Pour poser et/ou régler les pelotes thoraciques (E), desserrez le levier tournant (D) et déplacez-les sur le rail situé à l'arrière du dossier.
Ajustez la hauteur, l'angle et l'écartement des pelotes thoraciques à l'anatomie du patient en faisant coulisser les pelotes vers le haut ou le bas, le collier de serrage (F) de gauche à droite dans sa fente et en tournant le collier de serrage (F) autour du levier tournant (D). Une fois la position souhaitée obtenue, serrez le levier tournant (D). Pour retirer les rembourrages, voir 4.2.

4.5 Sangle pelvienne

Tous les BOB sont équipés d'une sangle pelvienne. Pour installer la sangle pelvienne, introduisez le clip de fixation dans l'ouverture située à l'arrière de la partie latérale. Assurez-vous que la sangle pelvienne s'enclenche bien.

Les utilisateurs qui glissent facilement vers l'avant dans le siège ont la possibilité de passer la sangle pelvienne par l'intérieur des supports du dossier. Pour assurer la position assise de petits utilisateurs actifs, le BOB de Taille 1 dispose d'une possibilité supplémentaire de pose de la sangle pelvienne. Passez la sangle par les crochets situés à l'arrière de l'assise.

Pour éviter des accidents, utilisez toujours la sangle pelvienne.

4.6 Sangle thoracique

La sangle thoracique est fixée aux pelotes thoraciques. Elle passe par l'intérieur des pelotes thoraciques.

Démontez d'abord les pelotes thoraciques (voir 4.4), passez les extrémités par la boucle (A) et replacez les pelotes und thoraciques.

4.7 Sangle thorax-épaules

Pour poser la sangle thorax-épaules, enlevez d'abord la partie centrale de la sangle pelvienne (A).
Employez pour ce faire la sangle thorax-épaules (B), qui dispose d'une sangle pelvienne intégrée. Ajustez la sangle pelvienne, puis passez les sangles d'épaule dans les fixations du dossier. Pour les personnes de petite taille, vous pouvez passer les sangles d'épaule également par l'ouverture supérieure du dossier.

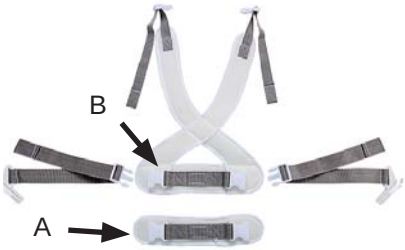

Tirez la sangle pelvienne sur la sangle thorax-épaules avant de tirer les sangles supérieures. Contrôlez la bonne tenue de la sangle après chaque réglage

4.8 Cales pour cuisses

La largeur du siège peut être adaptée grâce aux cales pour cuisses qui peuvent être fixées aux accoudoirs. En position 1, la largeur du siège diminue de 5 cm et en position 2 de 10 cm. Poussez les cales pour cuisses dans l'accoudoir en orientant l'échancrure (C) de la cale pour cuisse vers le haut et vers l'arrière. Passez l'accoudoir (D) par l'échancrure pour accoudoir située dans la cale pour cuisse. Pour retirer les rembourrages, voir 4.2.

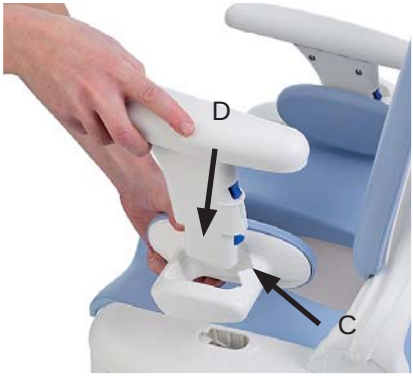

4.9 Repose-pieds

Le repose-pieds est un accessoire à monter sur le siège de toilette ou déjà fixé sur le bâti mobile.

4.9.1 Montage sur le siège de toilette

Veuillez tenir compte des remarques suivantes lors de la pose du repose-pieds sur le siège BOB.

1. Introduisez les petites fixations métalliques (A) aux extrémités du cadre (B) dans les logements (C) prévus à l'arrière du siège.
2. Appuyez fermement vers le bas sur le repose-pieds jusqu'à ce que le cadre s'enclenche avec un clic dans les fixations bleues (D).
3. Fixez le siège BOB sur les étriers de montage (voir 4.13). Le repose-pieds est compris dans l'emballage des bâtis mobiles.

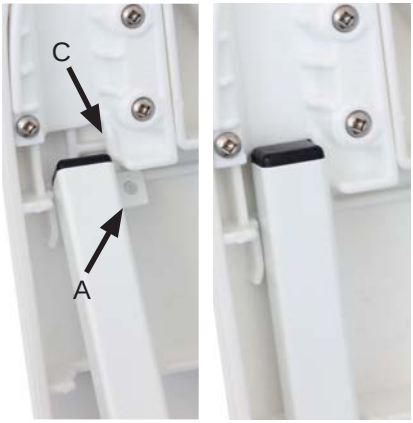

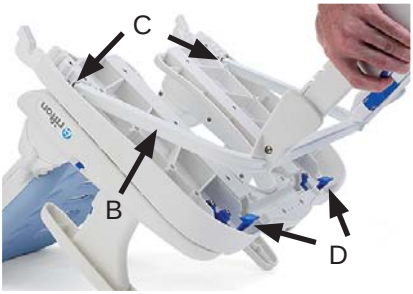

4.9.2Réglage en hauteur du repose-pieds

Réglez la hauteur du repose-pieds en pressant les deux boutons de réglage en hauteur (A), placez le repose-pieds à la hauteur souhaitée et laissez les boutons s'enclencher avec un clic dans la position souhaitée.

4.9.3Réglage de l'angle du repose-pieds

Réglez l'angle du repose-pieds en poussant les deux leviers (B) vers le haut et en sélectionnant entre quatre l'angle souhaité. Pour le transport au niveau du sol, le repose-pieds se rabat également vers l'intérieur.

4.10 Cale pour mollets

La cale pour mollets (C) se fixe au-dessus du repose-pieds (D). Elle doit être enlevée quand le repose-pieds est placé dans une des positions supérieures. La cale pour mollets se fixe sur les supports du repose-pieds. Orientez la sangle vers l'arrière et les extrémités arrondies vers le bas, enroulez la sangle autour des supports du repose-pieds et passez-la par devant à travers l'anneau en métal. Enclenchez le crochet et fixez la sangle en l'enroulant étroitement autour des supports.

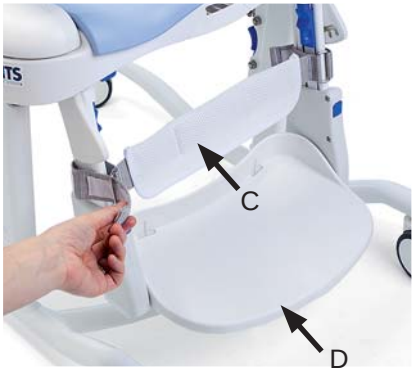

L'option cale pour mollets suppose l'utilisation d'un repose-pieds !

Pour éviter les chutes, bascules ou autres accidents, ne pas charger le repose-pieds de plus de 68 kg !

4.11 Attaches pour pieds

Pour poser les attaches pour pieds, passez la boucle de la sangle par l'ouverture horizontale située à l'arrière du repose-pieds. Tournez la sangle et poussez-la dans l'ouverture verticale. Tirez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Lavez les attaches à bandes auto-agrippantes à 30°C. Fermez les bandes auto-agrippantes avant le lavage. Ne pas repasser.

⚠ **Cette option suppose l'utilisation d'un repose-pieds !**

4.12 Table / tablette d'appui

La table présente au niveau de l'abdomen une grande surface rembourrée permettant à l'utilisateur de s'appuyer (pour retirer le rembourrage, voir 4.2). Elle offre une position penchée en avant confortable pendant le séjour aux toilettes ou sous la douche. Le tronc et les bras sont soutenus par la table. Pour régler la profondeur de la table, tirez le levier (A) situé dessous.

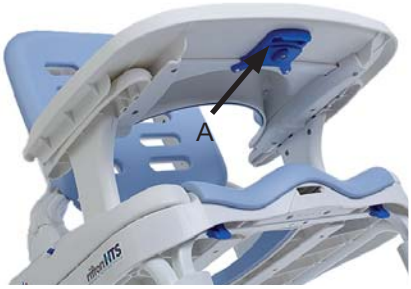

4.13 Étriers de montage

Il existe deux sortes d'étriers de montage, pour le montage sur des toilettes standard rondes ou sur des toilettes allongées

Les étriers de montage se montent avec les vis de fixation qui maintiennent le couvercle et la lunette. Ils constituent un point d'ancrage sûr pour le siège et le dossier.

Pour déterminer le type requis d'étrier de montage, mesurez l'écart entre l'axe central des vis de fixation et le bord avant du siège de WC. Si l'écart est de moins de 43 cm, utilisez l'étrier standard (A), sinon, l'étrier allongé (B).

Pour monter le siège sur l'étrier, basculez ou poussez le dossier vers l'avant (voir 3.1), placez les deux crochets (C) dans les prises de fixation (D) des étriers de montage (voir 4.1), puis abaissez le siège sur le siège des toilettes.

Pour éviter les chutes et les blessures, assurez-vous que les toilettes sont fermement fixées au sol et que les vis de fixation sont en bon état avant de poser les étriers de montage. Contrôlez la stabilité des toilettes et des vis de fixation à intervalles réguliers tant qu'un étrier de montage est en service.

4.14 Plot d'abduction

Le plot d'abduction rembourré se monte sur le bord avant du siège de toilette. Pour l'enlever, appuyez sur le levier bleu (E) tout en tirant le plot d'abduction vers l'avant.

Après chaque utilisation, désinfectez-le si possible avec des lingettes ou une solution contenant jusqu'à 10 % d'agent blanchissant. Tirez en forçant légèrement sur les rembourrages (voir 4.2) et nettoyez-les à l'aide d'une lessive savonneuse ou d'un désinfectant doux.

4.15 Déflecteur

Introduire le déflecteur standard (A) dans l'orifice du rembourrage de siège en orientant la partie creuse vers l'utilisateur. Le déflecteur avec protection anti-éclaboussures (B) assure une meilleure protection. Il est maintenu en contact avec l'utilisateur au moyen de la sangle pelvienne. L'utilisation conjointe du plot d'abduction et du déflecteur permet une meilleure stabilisation de l'utilisateur.

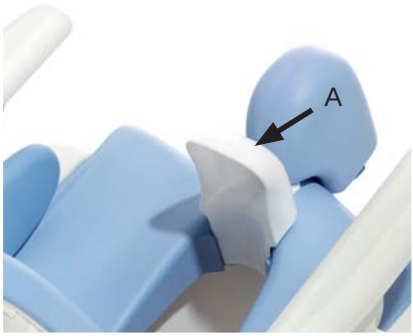

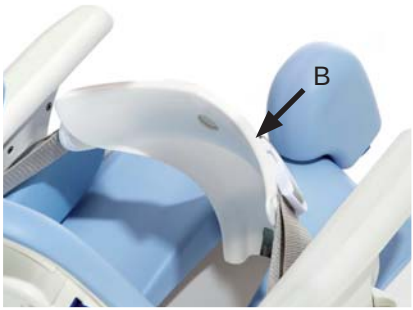

4.16 Seau hygiénique

Le seau hygiénique permet d'utiliser BOB en siège de toilette autonome. Introduisez le seau par l'arrière sur les rails situés sous le siège de toilette.
Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

5. Maintenance et nettoyage

5.1 Entretien

Après chaque utilisation, procéder si possible à un nettoyage avec des lingettes désinfectantes ou une solution contenant jusqu'à 10 % d'agent blanchissant. Lavez les attaches à bandes auto-agrippantes à 30°C. Fermez les bandes auto-agrippantes avant le lavage. Ne pas les repasser. Les rembourrages en polyuréthane sont facilement amovibles afin de faciliter le nettoyage et le séchage de la partie inférieure. Nettoyez-les à l'aide d'une lessive savonneuse ou d'un désinfectant doux.

N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, par exemple des solvants, des brosses dures, etc.

5.2 Maintenance

Veuillez effectuer un contrôle visuel quotidien du système hygiénique en vérifiant l'absence de fissures, ruptures, pièces manquantes et erreurs de fonctionnement. En cas de défectuosité ou d'erreur de fonctionnement, veuillez vous adresser directement à votre revendeur (voir point 8.5)

5.3 Pièces détachées

Pour commander des pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en indiquant le numéro de série de votre système hygiénique (voir point 8.5).

5.4 Durée d'utilisation et réutilisation

La durée d'utilisation prévue pour notre produit est de «8» ans maximum, compte tenu de l'intensité d'utilisation, du nombre de réutilisations et du respect des consignes du présent mode d'emploi. Le produit peut être utilisé au-delà de cette période si son état est fiable. La durée d'utilisation prévue ne concerne pas les pièces d'usure telles les housses, les roues, les batteries...

La maintenance, l'estimation de l'état et de l'aptitude à être réutilisé du produit incombent au revendeur.
Le système hygiénique est conçu pour être réutilisé. Avant de le céder à un tiers, veuillez le nettoyer et le désinfecter comme indiqué au chapitre 5.1. Les documents d'accompagnement. comme p. ex. ce mode d'emploi, sont des composants du produit et doivent être remis au nouvel utilisateur.

6. Caractéristiques techniques

Dimensions - Modèle de base

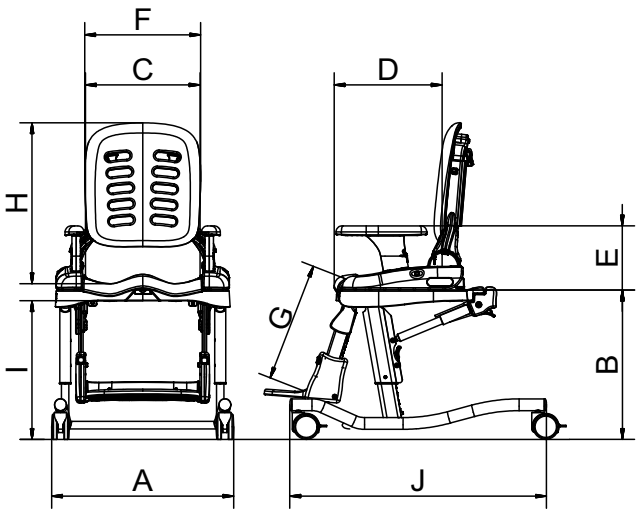

		BOB Taille 1	BOB Taille 2	BOB Taille 3
A	Largeur totale	54 cm	54 cm	60 cm
B	Hauteur siège bâti (mobile, réglage de l'angle d'assise)	38 – 55 cm	38 – 55 cm	41 – 57 cm
C	Largeur assise	20/25/30 cm	25/30/36 cm	33/38/43 cm
D	Profondeur assise	20/23/25/28 cm	29/32/34/37 cm	38/41/43/46 cm
E	Hauteur accoudoir	14,5/18 cm	14,5/18/22 cm	18/22 cm
F	Largeur dossier	29 cm	34 cm	41 cm
G	Longueur jambe siège de toilette	20 – 33 cm	25 – 38 cm	36 – 48 cm
H	Hauteur dossier	39 cm	48 cm	60 cm
I	Hauteur max des WC	48 cm	48 cm	51 cm
J	Longueur bâti mobile	82,5 cm	82,5 cm	82,5 cm
	Inclinaison dossier	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°
	Inclinaison assise	(-)15° - 15°	(-)15° – 15°	(-)15° – 15°
	Classe d'âge	env. 2 – 6 ans	env. 5 – 11 ans	à partir d'env. 9 ans
	Taille	76 – 117 cm	106 – 142 cm	127 – 188 cm
	Charge max	34 kg	68 kg	102 kg

7. Garantie

Le délai de garantie légal de deux ans s'applique à tous les produits. Ce délai débute à la livraison ou à la remise du produit. En cas de vice de matériau ou de fabrication prouvé sur la marchandise que nous avons livrée au cours de ce délai, retournez-nous la marchandise franco de port. Nous vérifierons le dommage signalé et, si besoin, nous serons libres de choisir de réparer ou d'en livrer gratuitement une nouvelle.

8. Identification

8.1 Déclaration de conformité CE

CE

La société **Schuchmann GmbH & Co.KG**
Dütestr. 3
D - 49205 Hasbergen
Tél. :+49 (0) 54 05 / 909 - 0
Fax :+49 (0) 54 05 / 909 - 109

déclare sur sa seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessous de la classe de produit 1

« **BOB** » - le système hygiénique universel
Art. n° : 57 01 000 (Taille 1) 57 02 000 (Taille 2) 57 03 000 (Taille 3)

est conforme aux dispositions en vigueur des directives et normes citées ci-dessous :

- Directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux du 14 juin 1993
- DIN EN 12182 Aides techniques pour les personnes handicapées
- EN ISO 14971 Dispositifs médicaux - Application de la gestion de risques pour les dispositifs médicaux
- ISO 7176-8 Fauteuils roulants- partie 8 : Exigences et méthodes d'essai pour la résistance statique, la résistance aux chocs et la résistance à la fatigue

La présente déclaration de conformité s'applique uniquement aux produits dont le numéro de série est mentionné ci-dessus.

Date 07/02/2014

Signature _____

Nom Torsten Schuchmann

Fonction Chargé de la sécurité pour les dispositifs médicaux

8.2 Numéro de série/Date de fabrication

SN ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ / ☐☐☐☐

Mois Année

La date de fabrication est lisible dans le numéro de série (mois/année).

8.3 Version du produit

Le système hygiénique BOB est disponible en trois tailles différentes et peut être complété par de nombreux accessoires (voir point 4).

8.4 Version du document

Mode d'emploi système hygiénique BOB
Statut de modification A, version 06/2014

8.5 Nom et adresse du fabricant, revendeur

Ce produit a été fabriqué par :

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tél. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Ce produit a été livré par le revendeur suivant :